



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.373.A № 63572

Срок действия до 15 сентября 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Теплосчетчики КАРАТ-Компакт 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное
предприятие "Уралтехнология" (ООО НПП "Уралтехнология"),
г. Екатеринбург**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 65137-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 77-221-2016

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **15 сентября 2016 г. № 1316**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев

2016 г.



Серия СИ

№ 027266

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Теплосчетчики КАРАТ-Компакт 2

Назначение средства измерений

Теплосчетчики КАРАТ-Компакт 2 (далее – теплосчетчики) предназначены для измерений тепловой энергии, объема и температуры теплоносителя в закрытых водяных системах теплопотребления и узлах учета тепловой энергии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.

Описание средства измерений

Принцип действия теплосчетчиков основан на измерении объема и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения и определении тепловой энергии по измеренным значениям.

Теплосчетчики состоят из преобразователя расхода, вычислителя и комплекта измерительных преобразователей температуры.

Теплосчетчики выпускаются в 6 модификациях и различаются по способу измерения объема теплоносителя:

- одноструйные – КАРАТ-Компакт 2-212;
- многоструйные – КАРАТ-Компакт 2-201, КАРАТ-Компакт 2-202;
- ультразвуковые – КАРАТ-Компакт 2-213, КАРАТ-Компакт 2-222, КАРАТ-Компакт 2-223;

Модификации теплосчетчиков имеют исполнения, которые различаются:

- диаметром проточной части и диапазоном измеряемых расходов.
- местом установки на трубопроводе:
 - ПТ – в подающий трубопровод;
 - ОТ – в обратный трубопровод.
- способом крепления вычислителя на преобразователе расхода:
 - МБ – моноблок;
 - СП – со съемным вычислителем.
- наличием или отсутствием импульсных входов и выходов:
 - от 0 до 3 входов;
 - от 0 до 3 выходов.

Теплосчетчики измеряют и отображают на ЖК-экране:

- тепловую энергию МВт·ч (Гкал);
- объем теплоносителя, м³;
- температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °C;
- разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °C;
- объем воды, измеренный счётчиками воды, подключенными к импульсным входам, м³;

Теплосчетчики отображают на ЖК-экране:


- мгновенный расход теплоносителя, м³/ч;
- мгновенную тепловую мощность, кВт (ккал/ч).

Теплосчетчики регистрируют, накапливают и сохраняют данные о потребленной тепловой энергии (суммарные с нарастающим итогом) в архивах в энергонезависимой памяти.

Конструкция теплосчетчиков обеспечивает:

- считывание информации через оптический интерфейс с помощью оптосчитывающей головки и с ЖК-экрана;
- дистанционную передачу информации при наличии коммуникационного канала M-bus, интерфейсов M-Bus, wM-Bus, RS485, радиомодуля.

Внешний вид теплосчетчиков с местами пломбирования представлен на рисунке 1.
Обозначение места нанесения знака поверки представлено на рисунке 2.

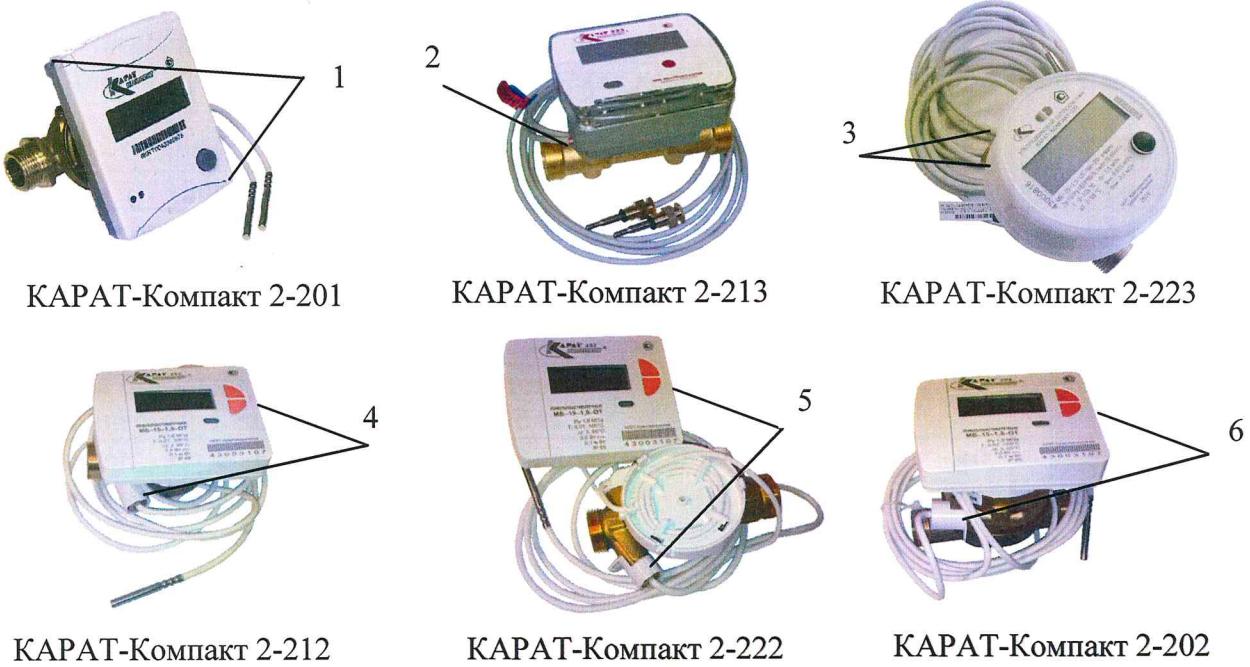

КАРАТ-Компакт 2-212

КАРАТ-Компакт 2-222

КАРАТ-Компакт 2-202

1 – 6 Места пломбирования при выпуске из производства

Рисунок 1 – Внешний вид теплосчетчиков КАРАТ-Компакт 2 и места их пломбирования



Рисунок 2 – Место нанесения знака поверки

Программное обеспечение

В теплосчетчиках применяется встроенное программное обеспечение (ПО). ПО разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части.

Идентификационные данные программного обеспечения, используемого в теплосчетчиках, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение				
	КАРАТ-Компакт 2				
	-213, -223	-212	-202	-222	-201
Идентификационное наименование ПО	Karat_kom-pakt_2x3.msc	Qh5_SV1e m.a43	Qh5_SV1e m2.a43	Qh5_SV1e m3.a43	Karat_kom-pakt_201.msc
Номер версии (идентификационный номер) ПО	4.112	171.02	172.01	160.09	4.1
Цифровой идентификатор ПО	7A29	6491	6491	00dC	2EC6
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC16	CRC16	CRC16	CRC16	CRC16

Теплосчетчики защищены от несанкционированного вмешательства пломбами. Программное обеспечение теплосчетчиков защищено ключом.

Уровень защиты программного обеспечения теплосчетчиков от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные метрологические и технические характеристики теплосчетчиков

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон измерений температуры, °C	от 0 до 105
Диапазон измерений разности температуры, °C	от 3 до 95
Суммарное значение с нарастающим итогом при измерении объема, м ³	до 99999,999
Суммарное значение с нарастающим итогом при измерении тепловой энергии, Гкал (ГДж, МВт·ч, кВт·ч)	до 99999,999
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, °C	$\pm(0,3 + 0,005 \cdot t)$ где t – измеренное значение температуры, °C
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении разности температуры, °C	$\pm(0,09 + 0,005 \cdot \Delta t)$ где Δt - значение разности температуры в подающем и обратном трубопроводах, °C
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема, % в диапазонах: от q_{min} до q_t (исключая) от q_t (включая) до q_{max}	± 5 ± 2
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии, %	$\pm(2+12/\Delta t + 0,01 \cdot q_{max}/q_i)$, где q_i и q_{max} - значение расхода теплоносителя и его наибольшее значение, м ³ /ч
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении и преобразовании количества импульсов, не менее 3000 импульсов, в измеряемые величины, %	$\pm 0,04$
Пределы допускаемого суточного хода часов, с	± 9
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6
КАРАТ-Компакт 2-201	
Диаметр условного прохода, мм	15
Максимальный расход q_{max} , м ³ /ч	1,2
Номинальный расход q_n , м ³ /ч	0,6
Переходный расход q_t , м ³ /ч	0,06
Минимальный расход q_{min} , м ³ /ч	0,024
КАРАТ-Компакт 2-202, КАРАТ-Компакт 2-212	
Диаметр условного прохода, мм	15
Максимальный расход q_{max} , м ³ /ч	1,2
Номинальный расход q_n , м ³ /ч	0,6
Переходный расход q_t , м ³ /ч	0,06
Минимальный расход q_{min} , м ³ /ч	0,024
КАРАТ-Компакт 2-213, КАРАТ-Компакт 2-222, КАРАТ-Компакт 2-223	
Диаметр условного прохода, мм	15
Максимальный расход q_{max} , м ³ /ч	3,0
Номинальный расход q_n , м ³ /ч	1,5

Наименование характеристики	Значение характеристики	
Переходный расход q_t , м ³ /ч	0,15	0,25
Минимальный расход q_{min} , м ³ /ч	0,015	0,025
Напряжение питания встроенного элемента, В: - КАРАТ-Компакт 2-202, -212, - 222	3,0 3,6	
- КАРАТ-Компакт 2-201, - 213, - 223	5	
Срок службы элемента питания, лет, не менее	110×90×125	130×90×120
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более	190	230
Длина проточной части с переходниками, мм, не более	1,5 (5,0)*	
Длина кабеля измерительного преобразователя температуры, м, не более	5,2	
Диаметр измерительного преобразователя температуры, мм, не более	1,5	
Масса, кг, не более	от 5 до 50	
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C	от 84 до 106,7	
- атмосферное давление, кПа	до 95	
- относительная влажность при температуре 35 °C, %	IP65	
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	75000	
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	12	
Средний срок службы, лет, не менее		
* - поставляется по отдельному заказу		

Знак утверждения типа

наносится на левый верхний угол титульного листа руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом, а также лазерной гравировкой или методом наклейки на лицевую панель теплосчетчика.

Комплектность средства измерений

Комплектность поставки теплосчетчиков приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплект поставки теплосчетчиков

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт 2	СМАФ.407200.002	1 шт.	
Проточная часть		1 шт. ¹	
Комплект монтажной арматуры		1 к-т.	
Комплект резьбовых соединителей		1 шт.	
Монтажная пробка		1 шт. ¹	
Паспорт	СМАФ.407200.002 ПС	1	
Руководство по эксплуатации	СМАФ.407200.002-0Х РЭ ²	1	
Методика поверки	МП 77-221-2016	1 ³	

Примечание:

- ¹⁾ Для КАРАТ-Компакт 2-201, -202.
- ²⁾ где Х – 1 для КАРАТ-Компакт 2- 201; 2 – КАРАТ-Компакт 2-202, -212, -222;
3 – КАРАТ-Компакт 2-213, - 223.
- ³⁾ Допускается поставлять один экземпляр в один адрес отгрузки

Проверка

осуществляется по документу МП 77-221-2016 «Теплосчетчики КАРАТ-Компакт 2. Методика поверки», утвержденному ФГУП «УНИИМ» 07.07.2016 г.

Основные средства поверки:

- эталон единицы объемного расхода воды 2 разряда по ГОСТ 8.374-2013 в диапазоне значений от 0,015 до 5 м³/ч;

- эталон единицы температуры 3 разряда по ГОСТ 8.558-2009 в диапазоне значений от 0 до 110 °C – 2 шт;
- эталон единицы частоты по ГОСТ 8.129-2013 в диапазоне значений от 0,001 до $4 \cdot 10^4$ Гц.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) паспорт теплосчетчика.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений содержится в руководстве по эксплуатации СМАФ.407200.002-01 РЭ, СМАФ.407200.002-02 РЭ, СМАФ.407200.002-03 РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теплосчетчикам КАРАТ-Компакт 2

ГОСТ 8.129-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты

ГОСТ 8.374-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) воды

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ГОСТ Р 51649-2014 Термосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 Термосчетчики. Часть 1. Общие требования

ТУ 4218-024-32277111-2015 Термосчетчики КАРАТ-Компакт 2. Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Уралтехнология» (ООО НПП «Уралтехнология»)

ИНН 6660080162

620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, к.130

тел.: (343) 2222-306, факс: (343) 2222-307

e-mail: support@karat-npo.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

тел.: (343) 350-26-18, факс: (343) 350-20-39

e-mail: uniim@uniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «УНИИМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311373 от 10.11.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

2016 г.